

25.10.18

4-7-Тел.

10 Сведения о приемке

Счетчик воды ВСКМ-20 ДГ - заводской № 118321419 соответствует техническим условиям ТУ 26.51.52.110-015-77986247-2016 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления 13 июня 2018 г.
 Дата ввода в эксплуатацию « » 201 г.
 Ответственное лицо за ввод в эксплуатацию _____

ООО «ПК Прибор»
 г. Москва
 Упаковщик № 26

11 Сведения о поверке

Счетчик на основании результатов первичной поверки, признан годным и допущен к эксплуатации.

Поверитель _____ Патрикеев В.С.
 (подпись)

М.П.

Поверен 13 июня 2018 г.

12 Сведения о периодической поверке

Дата поверки	Результаты поверки	МПИ	Знак поверки	Подпись и Ф.И.О. поверителя

Схематическое изображение счетчика показано на рис. 1, габаритные размеры счетчиков приведены в таблице 4.

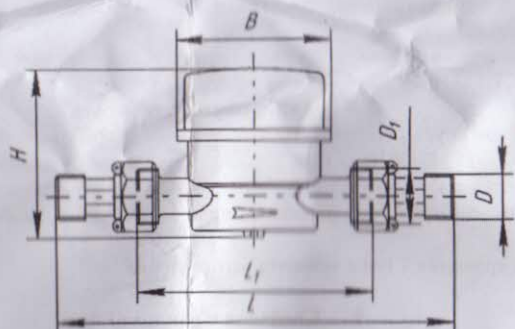


Рисунок 1 – схематическое изображение счетчика.

Таблица 4 – габаритные размеры счетчиков ВСКМ.

Условное обозначение счетчика	L ₂ , мм	L ₁ , мм	H, мм	B, мм	D ₁ , дюйм	D, дюйм	Масса, кг, не более
ВСКМ 15	190(160)	110(80)	85	77	G ¼	G ½	0,6(0,5)
ВСКМ 20	230	130	85	77	G 1	G ¾	0,7



ООО «ПК Прибор»
 СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
 ВСКМ 15, 20
 ПАСПОРТ
 ТС 26.51.52.110-015-77986247-2016



66635-17

1 Общие сведения об изделии

Счетчики воды крыльчатые модернизированные ВСКМ, предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, в системах холодного и горячего водоснабжения.

2 Метрологические и технические характеристики

Технические и метрологические характеристики счетчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1- метрологические характеристики счетчиков.

Наименование параметра	Норма для счетчиков диаметром условного прохода, Ду			
	15		20	
Диаметр условного прохода, Ду	15		20	
Метрологический класс	A	B	A	B
Расход воды, м ³ /ч:				
- минимальный q _{min}	0,06	0,03	0,10	0,05
- переходный q _t	0,15	0,12	0,25	0,20
- номинальный q _n	1,50		2,50	
- максимальный q _{max}	3,00		5,00	
Максимальный объем воды, м ³ , измеренный за:				
- сутки	37,5		62,5	
- месяц	1125,0		1875,0	
Порог чувствительности, м ³ /ч, не более	0,01		0,015	
Минимальная цена деления счетного механизма, м ³			0,0001	
Емкость счетного механизма, м ³			99999	
Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков:				
- в диапазоне расходов от q _{min} до q _t			±5	
- в диапазоне расходов от q _t до q _{max} , %, включительно			±2 (для счетчиков холодной воды)	
Потеря давления при q _{max} , Мпа, не более			0,1	
Максимальное рабочее давление, МПа			1,6	
Средняя наработка на отказ счетчиков, ч, не менее			100000	
Средний срок службы, лет, не более			12	
Условия эксплуатации:				
- температура окружающей среды, °С			От 5 до 50	
- относительная влажность, %			От 30 до 98	
- атмосферное давление, КПа			От 84 до 107	

2.1 Сигнал импульсного выхода счетчика ВСКМ ДГ соответствует требованиям к параметрам ГОСТ 26.013-81, указанным в таблице 2.